

Lietošanas instrukcija vietnē



Kāpšanas pa kāpnēm *motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med*



motion stair 900
motion stair 900 med

Saturs

1.	Vispārīgi	3
2.	Ierīču klasifikācija	3
3.	Drošības instrukcijas	4
	Iekārtas droša uzstādīšana	4
	Droša apmācība	5
	Indikācijas un kontrindikācijas	6
4.	Displeja darbība	7
	Pārskats par displeja/ taustiņu funkcijām	7
	Programmu atlase	8
	Impulsu sistēmas	8
	Induktīvā uzlāde (pēc izvēles)	9
5.	Kopšana, apkope un apkalpošana	9
	Kļūdu noteikšanas (darbības traucējumu) ceļvedis	12
	Tehniskās apkopes instrukcijas operatoram	12
	Pilnvarota speciālista veikta apkope	12
	Kalibrēšana/uzturēšana	13
6.	Tehniskie dati*	13
7.	Izmešana	13
8.	Garantija	14

1. Vispārīgi



Pirms treniņierīces **pirmās lietošanas reizes** uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu ar visiem drošības norādījumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu. Saglabājiet šo dokumentu turpmākai atsaucei un nododiet to citiem, ja nododat iekārtu tālāk.

Aprīkojuma mērķis ir kardiopulmonālā apmācība un reproducējama ķermeņa slodze, piemēram, diagnostikas un terapeitiskiem pasākumiem. Iekārtu galvenokārt izmanto lietotāji kardioloģijā, fizioterapijā, sporta medicīnā un mājas apstākļos. Vēl viens pielietojums ir izmantošana, lai veidotu un stiprinātu skeleta muskuļus, kā arī palielinātu treniņa laikā skarto locītavu mobilitāti.

Iekārtas ļauj reproducējami fiziski noslogot cilvēka ķermeni un sirds un asinsvadu sistēmu profilakses, rehabilitācijas un diagnostikas nolūkos.

Teksts ar pelēku fonu norāda uz teksta sadaļām, kas attiecas tikai uz fitnesa līnijas aprīkojuma funkcijām.

2. Ierīču klasifikācija

- *Cardio line med* ierīces ir medicīnas ierīces **MD** saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK, klasificētas IIa klasē. Bremžu kontroles diapazonā displeja precizitāte ir +/- 5 %.
- *Kardio līnijas* ierīces atbilst DIN EN ISO 20957-1 un DIN EN ISO 20957-5 standartam; pielietojuma klase S (komerciāla izmantošana/studija) un H (mājas izmantošana), precizitātes klase A +/- 10 %, un ir paredzētas tikai fitnesa un sporta nozarei.


Vienlaicīgi ar treniņierīci var nodarboties tikai 1 persona; nedrīkst pārsniegt maksimālo lietotāja svaru atbilstoši tipa plāksnei.

3. Drošības instrukcijas


Iekārtas droša uzstādīšana



1. attēls: Vienības sānu skats ar būtisko elementu apzīmējumu







- Novietojiet ierīci uz stingras, horizontālas, līdzenas un neslīdošas virsmas un izlīdziniet ierīci ar regulēšanas skrūvēm tā, lai tā neklīstu.
- Lai nodrošinātu drošu piekļuvi ierīcei un izklūšanu no tās arī ārkārtas situācijās, brīvajam laukumam ap ierīci jābūt vismaz par 1 m lielākam par ierīces kustības diapazonu. Tomēr drošības attālumi var pārklāties (sk. attēlu).



- Ierīci novietojiet tikai sausās telpās, .10°C
- Pārliecinieties, ka nav elektromagnētiskā starojuma, piemēram, no radio antenām, izstarojošām luminiscences lampām u. c., jo tie var ietekmēt impulsu mērījumus.
- Rāmja apakšējai daļai vienmēr jābūt brīvai, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Visas šeit minētās vienības ir neatkarīgas no elektrotīkla. Darbības laikā tās pašas ražo elektroenerģiju vai programmēšanas laikā tās tiek apgādātas ar enerģiju no standarta iebūvētā kondensatora. Kondensatoru uzlādē ar apmācību, un tā kalpošanas laiks ir > 20000 ciklu.
- **Uzmanību:** vienmēr ievērojiet šīs rokasgrāmatas 5. nodaļā sniegtos norādījumus par kopšanu, apkopi un apkalpošanu.

Droša apmācība

- Pirms apmācības uzsākšanas piemērotība apmācībai jāpārbauda pilnvarotai personai, piemēram, ārstam. Lūdzu, ņemiet vērā punktu "Indikācijas un kontrindikācijas".
- Ņemiet vērā, ka pārmērīga fiziskā slodze var būt kaitīga.
- Ja rodas slikta dūša vai reibonis, nekavējoties pārtrauciet treniņu un konsultējieties ar ārstu.
- Treniņi ar aprīkojumu ir atļauti tikai ar neskartu ādu.
- Treniņu laikā vēlams lietot cieši piegulošu, vieglu sporta apģērbu, lai treniņa laikā tas nevarētu iesprūst ierīces daļās. Vienmēr valkājiet piemērotus sporta apavus, lai nodrošinātu drošu soli uz pedāļiem.
- Pirms apmācības uzsākšanas pārbaudiet, vai ierīce ir drošā stāvoklī, vai tajā nav bojātu detaļu vai iespējamu manipulāciju. Ja konstatējat defektus vai neesat pārliecināts, pirms apmācības uzsākšanas jautājiet vadītājam.
- Pirms apmācības uzsākšanas pārliecinieties, ka neviens neatrodas kustīgo daļu tuvumā, lai neradītu apdraudējumu trešajām personām. Bērni bez uzraudzības nedrīkst atrasties tuvāk iekārtai.
- **Uzmanību:** pakāpieni, uz kuriem lietotājs stāv vingrinājuma laikā, tiek pacelti augšējā sākuma pozīcijā ar pietiekami spēcīgām atsperēm. Lai izvairītos no traumām, ko izraisa pēdu lēkšana atpakaļ, lietotājam uz treniņiera jāuzkāpj šādi.
 - Jūs stāvat ierīces priekšā un ar rokām turaties pie stūres.
 - Vispirms uzvelciet vienu kāju uz pedāļa un nospiediet to līdz grīdai.
 - Uz šī pedāļa pilnībā novietojiet ķermeņa svaru.
 - Tagad ar otru kāju nospiediet otru pedāli uz grīdas.
 - Tagad abi pedāļi ir nolaisti
 - Tagad sāciet kustināt abas kājas un ieejiet kāpņu kustības funkcionālajā zonā. Ja to darāt pareizi, ar pedāli netrāpīsiet ne augšējā, ne apakšējā gala punktā.
 - Ja atkal vēlaties pārtraukt vingrinājumus, ļaujiet sev slīdēt uz leju ar abiem pedāļiem, līdz pieskaras zemei.
 - Tagad viņi ļauj pedālim lēnām pacelties uz augšu, radot pietiekamu pretspiedienu.
 - Ja pedālis ir augšējā apstāšanās punktā, varat nolaist kāju uz grīdas ierīces priekšā un ļaut otram pedālim kustēties uz augšu tādā pašā veidā, bremzējot.
 - Ja arī otrais pedālis ir pieturas augšpusē, noņemiet kāju no pedāļa.
 - Vairākas reizes praktizējieties uzkāpt un izkāpt no treniņiera, lai varētu to droši izmantot - pat tad, ja treniņa laikā esat guvis zināmu noguruma līmeni.

-  **Brīdinājums:** Sirdsdarbības monitoringa sistēma ir jutīga pret kļūmēm sistēmas dēļ. Pārmērīga fiziskā slodze var izraisīt bīstamas traumas vai nāvi. Ja jūtaties slikti, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumus un konsultējieties ar ārstu vai terapeitu.
-  **Brīdinājums:** Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar korpusu un sausās telpās.
-  **Brīdinājums par papildu barošanas pieslēgumu:** Izmantojiet tikai apstiprinātus barošanas avotus, kas ir pārbaudīti saskaņā ar IEC 60601-1 un ko apstiprinājis ierīces ražotājs. Pārliecinieties, ka barošanas avots ir uzstādīts tā, lai to būtu grūti atvienot (piemēram, ar grīdas tvertnēm, uzstādīšanu zem ierīces vai kabeļu kanāliem, barošanas avota novietojumu grūti pieejamās vietās).
-  **Brīdinājums:** Ja medicīnas ierīce tiek pārveidota, jāveic attiecīgi pētījumi un testi, lai nodrošinātu turpmāku drošu lietošanu. Neveiciet ierīces modifikācijas bez ražotāja atļaujas.

Indikācijas un kontraindikācijas

Pirms treniņu uzsākšanas konsultējieties ar ārstu vai terapeitu, lai pārliecinātos, vai esat gatavs treniņiem.

Indikāciju piemēri

- Skeleta-muskuļu sistēmas mobilitāte
- Muskulatūras stiprināšana
- Sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšana

Kontraindikāciju piemēri

- Sirds un asinsvadu slimības
- Sāpes muskuļu un skeleta sistēmā
- Apmācību laikā:
 - Sāpes krūtīs
 - Malaise
 - Slikta dūša
 - Reibonis
 - Elpas trūkums

Jautājiet ārstam, ja lietojat medikamentus.

4. Displeja darbība

Trīs vai deviņas treniņu programmas ļauj individuāli un daudzveidīgi trenēties ar motion stair 900 un motion stair 900 med.

	kāpnes 900 / 900 med
Pamataprīkojums	Ātrā sākšana, treniņš ar laika grafiku, pulsa treniņš
ieskaitot programmas paketi	Ātrā sākšana Kvalifikācijas Pulsa apmācība + vēl 6 programmas

Pārskats par displeja/ taustiņu funkcijām



PAUZE



STOP

PLAY

2. attēls: Monitors skats, kurā paskaidrotas pogu funkcijas, faktiskais skats var atšķirties pēc krāsas, bet pogu piešķiršana ir tāda pati.

Pogu skaidrojums:

- **Sākuma poga** ir fiziska poga zem displeja stikla. To nospiež, lai ieieta galvenajā izvēlnē. Nospiežot HOME pogu uz ilgu laiku (vismaz 6 sekundes), tiek atiestatīta monitora elektronika.
- Nospiediet **PAUZES** pogu (||), lai apturētu treniņu.
- Nospiežot **PLAY** pogu (▶), tiek uzsākta vai atsākta apmācība.
- Nospiežot **COOL** pogu (❄️), apmācība tiek nekavējoties pārtraukta. Treniņa rezultātu kopsavilkums tiek nekavējoties ģenerēts, parādīts un, ja nepieciešams, nosūtīts uz saderīgu treniņa vadības programmatūru.
- Izmantojiet **taustiņu "+" vai "-"**, lai palielinātu vai samazinātu iestatāmos parametrus vai jaudas vērtības.
- Izmantojiet **bulftaustiņus**, lai pārvietotos pa attiecīgajām izvēlnēm un apstiprinātu vērtības vai iestatījumus.
- Pārvelciet/noslaukiet žestus, lai pārvietotos pa programmu atlasī.

Atkarībā no programmas tiek parādīti daži no šiem parametriem:

- Programmas nosaukums.
- Laiks: pabeigtais vai atlikušais treniņa laiks.
- Pulss: sirdsdarbības frekvences indikators, ja tiek izmantota saderīga pulsa raidītāja josta. Pulsa indikatora displejā tiek parādīts pašreizējais pulsa diapazons programmām ar mērķa vai maksimālo pulsu. Profila indikators displejā parāda intensitātes diapazona progresēšanu treniņa laikā.
- Watt: jauda tiek parādīta vatos. Paralēli intensitāte tiek precizēta, izmantojot grafisko displeju profilā.
- km/h: Fiktīvais ātrums tiek parādīts km/h.
- Ātrums: pedāļa apgriezieni minūtē.
- L/R (nav ar virsbūvi 900/900 med): Šeit tiek parādīta kreisās un labās kājas spēka attiecība %.
- HRV: sirdsdarbības frekvences mainīgums tiek parādīts, izmantojot RMSSD vērtību (nepieciešams **POLAR** H10 sensors).
- resp: Elpošanas ātrums (nepieciešams **POLAR** H10 sensors).
- km: Pievienots vai atlikušais attālums. Rādījums ir metros; no 1000 m pa 10 m (1,00 km).

- K-Cal: pievienoto vai atlikušo kaloriju patēriņš.
- Līmenis: Intensitātes līmenis 1 - 21.
- Ø: Ja parametri ir papildināti ar šo simbolu, tie ir vidējās vērtības.

Rezultāti


Pēc treniņu programmas pabeigšanas vai priekšlaicīgas pārtraukšanas, izmantojot COOL (❄️), monitorā tiek parādīti rezultāti un notiek 3 minūšu atdzišana. To var atcelt, izmantojot HOME pogu.

Dažas vērtības ir vidējās (Watt, Km/h, RPM, pulss, augstums/ min), dažas ir kumulētas (Km, K-Cal, laiks, augstums). Vidējās vērtības ir atzīmētas ar simbolu Ø.

Šie rezultāti ļauj uzraudzīt personīgo snieguma attīstību un tādējādi kalpo kā motivācija.

Programmu atlase

Vēlamo mācību programmu var izvēlēties galvenajā izvēlnē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Pēc tam tiks atvērta konfigurācijas lapa, kurā var iestādīt attiecīgos apmācības parametrus. Nospiediet **PLAY** pogu (▶️), lai apstiprinātu ierakstu un sāktu treniņu. Jūs varat atgriezties galvenajā izvēlnē, izmantojot sākuma ikonu vai sākuma pogu.



3. attēls: Programmas izvēle un konfigurācija manuālai apmācībai.

Impulsu sistēmas

Motion cardio line 900 un Motion cardio line 900 med ierīcēm ir oriģinālā **POLAR** impulsu sistēma, kurā signāla iegūšana tiek veikta, izmantojot standarta krūšu siksnu. Tas ļauj veikt individuālus treniņus dažādās programmās. Bezvadu datu pārraide uz displeja elektroniku ir kodēta (5 kHz vai Bluetooth®). Jaunā **POLAR** "Auto-Pairing" tehnoloģija ir balstīta uz drošu un no traucējumiem brīvu datu pārraidi, izmantojot Bluetooth. Šai tehnoloģijai ir nepieciešams izmantot H10 vai H9 raidītājus. Arī citi parametri, piemēram, HRV un elpošanas frekvence, tiek pārraidīti uz monitoru, izmantojot Bluetooth® savienojumu.

Ja tiek izmantoti vecie raidītāji, piemēram, ar kodu T31, tiek nodrošināta lejupejoša savietojamība. Tomēr jāņem vērā, ka var rasties traucējumi signāla pārraidei, izmantojot 5 kHz tehnoloģiju.



Mirgojošā sirds simbola krāsa norāda uz izmantoto tehnoloģiju.

gaiši zils = Bluetooth zaļš = 5kHz

ANT+

Papildus sirds darbības frekvences pārraidei, izmantojot 5 kHz/Bluetooth®, kustību kardio līnijas 900 un kustību kardio līnijas 900 med ierīces ļauj pēc izvēles pārraidīt datus, izmantojot ANT+. Šim nolūkam ir nepieciešama veiktspējas pakete.

Pēc noklusējuma ir aktivizēta Polar 5kHz/Bluetooth® tehnoloģija. Lai aktivizētu pārraidi, izmantojot ANT+, informācijas lodziņā (☰) ir jāieslēdz slēdzis "ANT+" (šeit atzīmēts dzeltenā krāsā). Pēc tam var izveidot savienojumu ar raidītāja vienību, kas nosūta sirds darbības datus, izmantojot ANT+. Tumši zils mirgojošs sirds simbols apstiprina sirds darbības pārraidi, izmantojot ANT+.

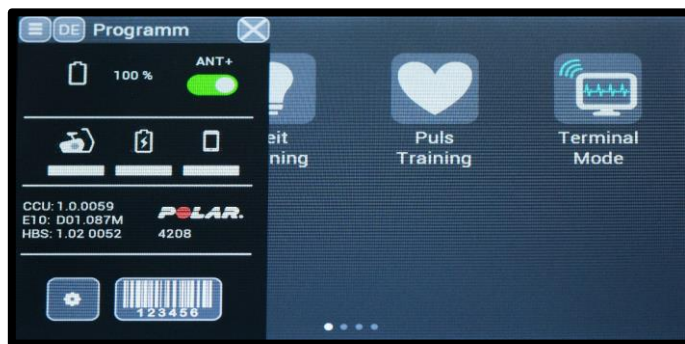

4. attēls: ANT+ aktivizēšana sirdsdarbības pārraidei

Drošības instrukcija saskaņā ar DIN EN ISO 20957

Brīdinājums. Sirdsdarbības monitoringa sistēmas var būt neprecīzas. Pārmērīga fiziskā slodze var izraisīt nopietnu veselības bojājumu vai nāvi. Ja jūtat reiboni vai vājumu, nekavējoties pārtrauciet vingrinājumus.

Induktīvā uzlāde (pēc izvēles)

Opcionālo induktīvās uzlādes moduli var aktivizēt visām ierīcēm motion cardio line 900 un motion cardio line 900 med, izmantojot "savienojuma paketi". Tas ļauj uzlādēt mobilās ierīces, kas atbilst Qi standartam (Φ), bez kontakta. Kardiostimulatoru vai implantētu defibrilatoru (ICD) nēsātājiem ieteicams ievērot vismaz 10 cm attālumu no uzlādes spoles.








5. Kopšana, apkope un apkalpošana

Visas emotion fitness kardio iekārtas ir izturīgas un prasa nelielu apkopi, lai ilgstoši kalpotu kā treniņu aprīkojums. Tomēr ir obligāti jāveic nepieciešamā kopšana.

⚠ Brīdinājums: ierīci drīkst atvērt tikai pilnvarots speciālists.

Simboli un nozīme

Drošības zīme	Atsauce	Nosaukums
	ISO 7010-P017	Stumšana aizliegta
	ISO 7010-W012	Brīdinājums, elektrība
	ISO 7000-1641	Lietošanas instrukcija
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Drošības paziņojums Sirdsdarbības ritma uzraudzība
	ISO 7000-3082	Ražotājs

	ISO 7000-2497	Izgatavošanas datums
	ISO 7000-0632	Temperatūras robeža
	ISO 7000-2620	Gaisa mitrums, ierobežojums
	ISO 7010-W001	Vispārējā brīdinājuma zīme
	ISO 7010-M002	Ievērojiet lietošanas instrukcijas
	IEC 60417-5840	B tipa uzklātā daļa (attiecas uz sēdekli, pedāļiem un stūri)
	ISO 15233	Medicīniskās ierīces

Vienību drošības līmeni var saglabāt tikai tad, ja tās regulāri pārbauda, vai nav bojājumu un nodiluma. Bojātās detaļas nekavējoties jānomaina un ierīce ir jāizslēdz, līdz tā tiek salabota.

Kļūdu diagnostika

Var parādīties šādi kļūdas ziņojumi. Ja kļūda tiek parādīta atkārtoti, var palīdzēt turpmāk minētie pasākumi. Ja tie nedod rezultātu, jāsaazinās ar ražotāju un, ja nepieciešams, ar programmatūras ražotāju.

Kļūdas ziņojums	Pasākums/pasākumi	Skartie vienību tipi
"RFID kļūda"	<ul style="list-style-type: none">RFID numurs, t. i., transpondera numurs ir pārāk īss vai pārāk garš.RFID numura nolasīšanas laikā ir notikusi kļūda. → izmantot citu transponderi	Visi ergometri
"Sirds sensors?"	Monitors vēlas sākt programmu, kurai nepieciešams nēsāt sirdsdarbības sensoru. Ja sensors nav atrasts, tiek parādīts šis ziņojums.	Visi ergometri
"USB problēma"	Radio ziņojums tika veiksmīgi nosūtīts no monitora radio moduļa uz datora radio moduli (t. i., uztvērēja modulis apstiprināja ziņojuma saņemšanu), bet pēc norādītā laika perioda no datora nav saņemta atbilde: → Restartējiet datoru un atkal pievienojiet USB dongle datorā. Ja nepieciešams, restartējiet programmatūras pakalpojumu.	Visi ergometri
"Radio problēma"	<ul style="list-style-type: none">Ierīce nesaņem atbildi no USB dongle. Uzmanību! Šis kļūdas ziņojums var tikt parādīts arī tad, ja no dongle uz monitoru nosūtītais ziņojums ir kļūdainš (piemēram, nepareizs formāts vai ziņojums nav pilnīgs). → Restartējiet datoru un atkal pievienojiet USB dongle datorā. Ja nepieciešams, restartējiet programmatūras pakalpojumu.	Visi ergometri
"NDEF kļūda: garums"	<ul style="list-style-type: none">Uz NFC birkas atrastā ziņa (t. i., no viedtālruna pārraidītā ziņa) ir pārāk gara. → Sazinieties ar programmatūras vai ierīces ražotāju	Visi ergometri
"NDEF kļūda: pārbaudīt"	<ul style="list-style-type: none">NFC tagam nevarēja piekļūt. Šī ir autorizācijas problēma, kad NFC tagam piekļūstat caur monitoru, izmantojot super paroli. → Sazinieties ar ražotāju vai programmatūras ražotāju	Visi ergometri
Trūkstošā vērtība: XX (XX = skaitlis)	<ul style="list-style-type: none">Datora programmatūra nav nosūtījusi uz ergometru nepieciešamo iestatījumu parametru → Sazinieties ar ražotāju vai programmatūras ražotāju.	Visi ergometri
Vērtība XX ārpus diapazona (XX=skaitlis)	<ul style="list-style-type: none">Nepieciešamais iestatīšanas parametrs no datora programmatūras uz ierīci tika nosūtīts ārpus pieļaujamā diapazona → sazinieties ar ražotāju vai programmatūras ražotāju.	Visi ergometri

Kļūdu noteikšanas (darbības traucējumu) ceļvedis

Ja iekārtā rodas kādi bojājumi, kurus nevarat klasificēt, lūdzu, sazinieties ar emotion fitness GmbH & Co.KG. Katram kļūdas ziņojumam ir jāsaņemta bojātās ierīces sērijas numurs un modeļa tips, jo tas var būt svarīgi, lai varētu veikt pareizu diagnostiku un, pats galvenais, lai nodrošinātu jums atbilstošas rezerves daļas!

Tehniskās apkopes instrukcijas operatoram

Ideālā gadījumā vizuāli pārbaudiet ierīci pirms katras lietošanas reizes, bet vismaz katru dienu, un pievērsiet īpašu uzmanību bojātām detaļām, vaļīgiem savienojumiem un netipiskiem trokšņiem.

Vismaz reizi 6 mēnešos jāveic šādas pārbaudes:

- Vizuāli pārbaudiet visus redzamos savienojumus, kā arī šuves.
- Rūpīgi iztīriet ierīci.
- Pārbaudiet visu skrūvju savienojumu hermētiskumu.
- Pārbaudiet pedāļu integritāti un izturību.

Vispārīgi runājot:

- Plastmasas korpusa un rāmja daļas regulāri pēc vajadzības notīriet ar mitru drānu un maigām ziepēm, pēc tam noslaukiet līdz sausumam.
- Nav atļauts izmantot izsmidzināšanas pudeles ar tīrīšanas līdzekļiem; ir pierādīts, ka nepieejamās vietās ierīces nekad neizžūst. Ar šo procedūru nevar izslēgt rūsas invāziju.
- Pārliecinieties, ka monitora korpusā nav iekļuvis šķidrums,
- Nepieciešamajai ierīču dezinfekcijai izmantojiet tikai mikrocid® sensitīvas dezinfekcijas salvetes (<http://www.schuelke.com/>).
- Monitora displejā var parādīties pārāk zems kondensatora spriegums, pie kura nevar droši garantēt funkciju bez bremsēšanas strāvas. Kondensatoru var uzlādēt, minot pedāļus ar lielāku slodzi vai izmantojot ierīces ražotāja apstiprinātu barošanas bloku.
- Pārbaudiet korpusa stiprinājumu hermētiskumu.
- Mēs iesakām regulāri vizuāli pārbaudīt visas ierīces daļas, īpaši skrūves, šuves un citus stiprinājumus.
- Pārbaudiet, vai ierīces kājas ir stingri nostiprinātas.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas - par to sazinieties ar mums.

Pilnvarota speciālista veikta apkope

Ja ar ierīci rodas problēmas, kurās nevarat atrisināt paši, vienmēr sazinieties ar emociju fitnesa dienestu. Pilnvarotais dienests ātri un kompetenti palīdzēs jums vai sniegs jums norādījumus.

Kalibrēšana/uzturēšana

Eliptisko un kāpšanas pa kāpnēm iekārtu (krustu un kāpņu) operatoram MTK likums neprasa. Tas ir tāpēc, ka ķermeņa svars ietekmē šo trenāžieru radīto jaudu. emotion fitness GmbH & Co. KG pēc pieprasījuma piedāvā kalibrēt bremžu jaudu.

Turklāt mēs iesakām **reizi 12 mēnešos** veikt **tehnisko apkopi**, pārbaudot ar drošību saistītās sastāvdaļas (STÜ), ko veic pilnvaroti darbinieki/partneri.

Šī sadaļa attiecas uz juridisko situāciju Vācijā. Lūdzu, pārbaudiet savā valstī piemērojamos tiesību aktus par medicīnas ierīču ekspluatāciju.

Ierīces ar sufiksu "med" ir saskaņā ar Medicīnas ierīču direktīvu 93/42/EEK. Tādējādi uz tām ir CE zīme un pilnvarotās iestādes numurs.

Izplatītājs/apsaimniekotājs ir atbildīgs par tehniskās apkopes, apkopes un kalibrēšanas veikšanu, kā arī par iespējamām pārbaudēm saskaņā ar spēkā esošajiem reģionālajiem likumiem un noteikumiem iekārtas atrašanās vietā!

Sīkāku informāciju var sniegt arī vietējais pilnvarotais izplatītājs.

6. Tehniskie dati*

Ierīces tips	Izmēri (L/W/H)	Svars	Maksimālais lietotāja	Droša darba slodze
kustību kāpnes 900 kustību kāpnes 900	102 cm x 73 cm x 160 cm	79 kg	150 kg	229 kg

Pretestības sistēma: bremžu sistēma, kas nav atkarīga no galvenās bremžu sistēmas.

Jaudas diapazons: 4-27 m/min. Izplūdes ātrums

Brīvais ritenis: pieejams

Ir izpildītas šādas ES direktīvas:

2001/95/EK Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību

93/42/EEK Medicīnisko ierīču direktīva IIa klase (atbilst tikai ierīcēm ar sufiksu med).

2014/30/EU EMC direktīva

Tika izmantoti šādi standarti:

DIN EN ISO 20957-1 Precizitātes klase A, lietošanas klase SH; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Vērtības var atšķirties vienību izmaiņu un opciju dēļ.

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas un optiskas izmaiņas, kā arī drukas kļūdas.

7. Izmešana

Noslēdzot pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka ir panākta vienošanās, ka biznesa klienti atbrīvosies no ES Direktīvu 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

8. Garantija

Tas pamatojas uz likumā noteikto garantiju.

emotion fitness GmbH & Co. KG kā šī produkta izplatītājs nodrošinās bezmaksas servisa pakalpojumus 12 mēnešu garumā attiecībā uz detaļām un darbu profesionāliem lietotājiem, ja tiks pārbaudīta šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītā pareiza lietošana un kopšana. Vēl 12 mēnešus emotion fitness GmbH & Co. KG bez maksas nodrošinās rezerves daļas. Garantijas prasība zaudē spēku, ja produktu apkalpoja vai remontēja nepiederošas personas. Tiklīdz rodas garantijas pretenzija, jums par to nekavējoties rakstiski vai pa e-pastu jāinformē emotion fitness GmbH & Co KG. Ierīces īpašniekam ir jāsniedz informācija par ierīces sērijas numuru, iegādes laiku, detalizēts defekta apraksts un piegādes avots.

emotion fitness GmbH & Co KG nodrošinās pakalpojumu, taču patur tiesības noteikt pakalpojuma veidu.

Ir iespējamas šādas procedūras:

1. pakalpojumu uz vietas veic mūsu dienests.
2. mēs nosūtām vēlamo rezerves daļu.
3. mēs nosūtīsim rezerves vienību.

Klientam bojātās detaļas mums nekavējoties jānosūta atpakaļ. Pretējā gadījumā par piegādātajām rezerves daļām tiks izrakstīts rēķins.

Ja cēloņi ir ārpus garantijas darbības jomas, emotion fitness GmbH & Co. KG patur tiesības iekasēt visas remonta izmaksas.

Garantija neattiecas uz dažām nodilstošām detaļām. Tās jo īpaši ir sēdeklis, kloķi un kloķa stiprinājums, pedāļi, pedāļu cilpas, polsterējuma audumi un roktura gumijas rokturim. Uz **POLAR** pulsa sistēmām attiecas juridiskā garantija.

Šie garantijas noteikumi nekādā veidā neietekmē vispārējās likumā noteiktās prasības.

Mūsu Vispārīgos piegādes noteikumus un nosacījumus, kas laiku pa laikam tiek grozīti, var apskatīt un lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes www.emotion-fitness.de.

CE 0633

Paldies par uzticēšanos!

emotion
FITNESS

Ražotājs

emotion fitness GmbH & Co. KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer, Vācija

Tālrunis +49 (0) 6305-71499-0

Fakss +49 (0) 6305-71499-111

Internets: www.emotion-fitness.de

E-pasts: info@emotion-fitness.de

Ražotājs EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

